


KP.B. XIV.32

Dreipunkttraste aus
Eisen. Am Ende des
Stumpfs montiert
verhindert sie das
Verdrehen der
Prothese in Querrichtung.
Die drei Stifte im Inneren
der Prothese gleiten beim
Ansetzen in die Schlitz

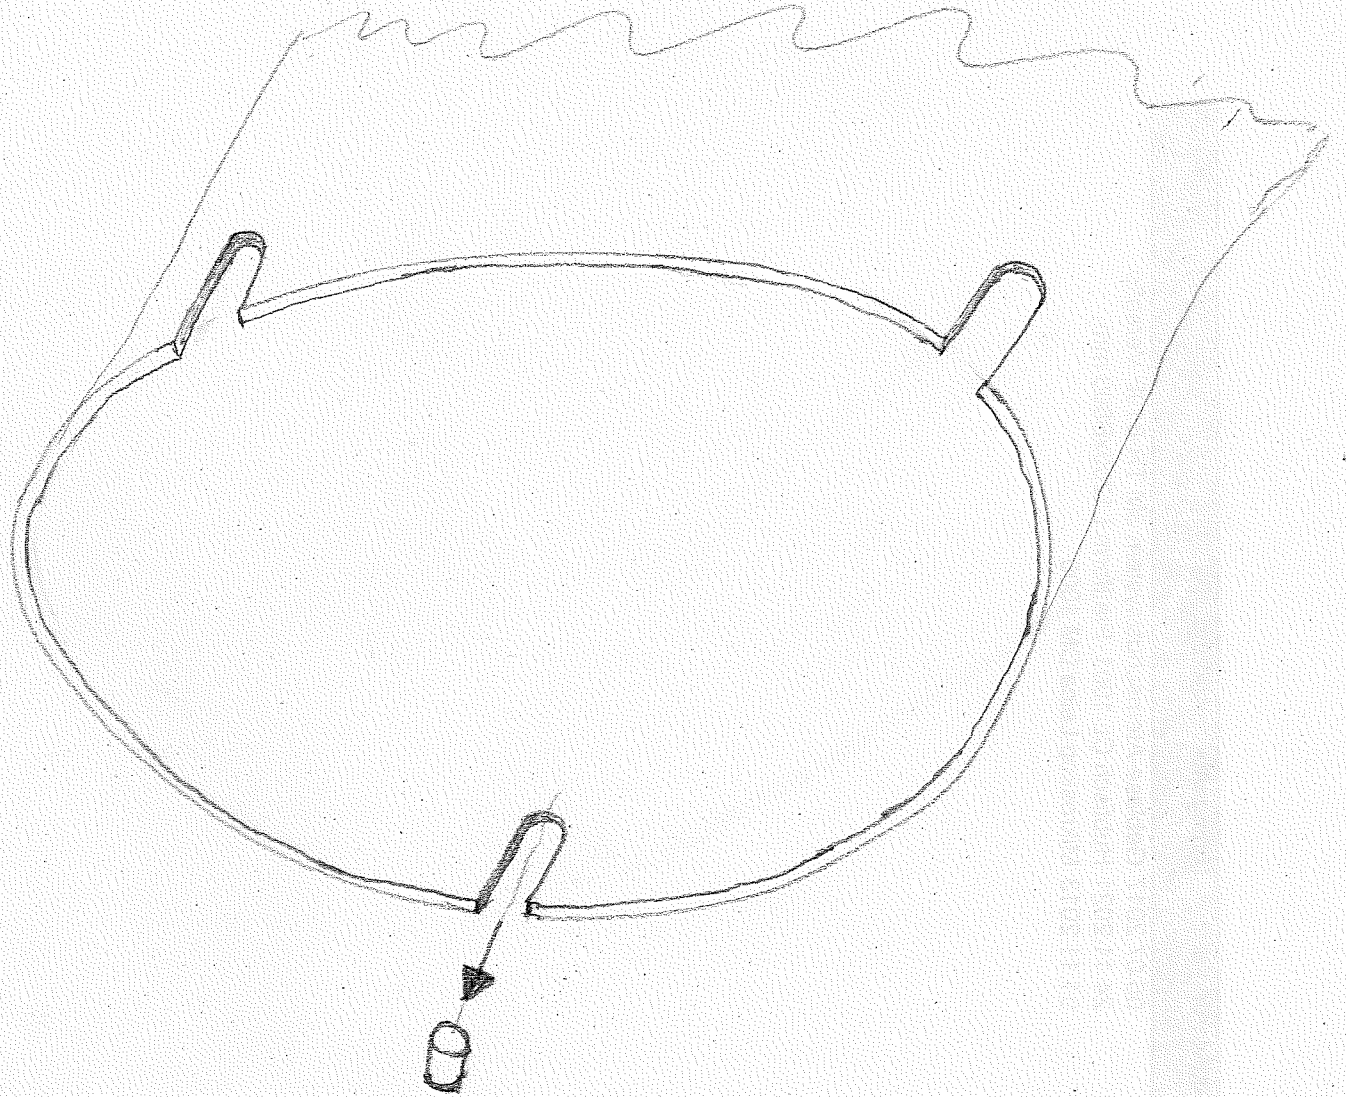

19. August 2025 *THG*